


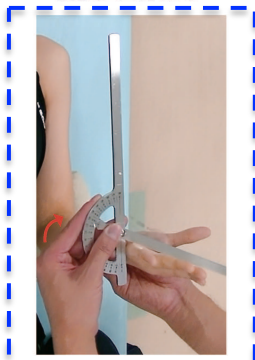

『臨床での測定精度を高める！ ROM測定法 代償運動のとらえ方と制動法の理解と実践』

正誤表

『臨床での測定精度を高める！ ROM測定法 代償運動のとらえ方と制動法の理解と実践』第1版第1刷(2016年3月30日)に誤りがありました。

ここに深くお詫びいたし、訂正申し上げます。

(2016年12月27日 メジカルビュー社編集部)

ページ	誤	正
p.105	<p>■手指を伸展した手掌面</p>  <p>■前腕遠位背側部</p>  <p>写真が逆</p>	<p>■手指を伸展した手掌面</p>  <p>■前腕遠位背側部</p> 